

**Cliente:** " CONTEMP INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA "

**Endereço:** Alameda Araguaia, 204 - São Caetano do Sul - SP

**Ordem de serviço:** 12095

### 1 - Objeto calibrado:


**Calibrador Anel Liso Cilindrico**

Fabricante: Ferriplax

Número de série: F101028

Código: Não consta

Identificação do proprietário: LAPA-008

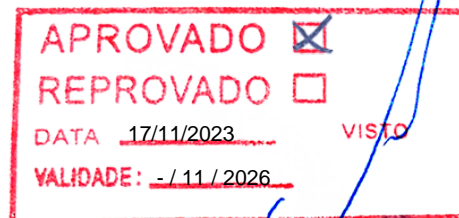

### 2 - Padrões utilizados na calibração:

Calibrador anel liso cilíndrico

N° série: 0632

Certificado N° DIMCI 0167/2021 - INMETRO

Validade: 03/2024

Maquina de medição por coordenadas

N° série: 0004501

Certificado N° 02549/23 - RBC - Mitutoyo

Validade: 07/2024

### 3 - Procedimento de medição: PML-0010 - Revisão: 8

O diâmetro do anel foi calibrado nos eixos X e Y, em três alturas, conforme figura abaixo.

### 4 - Resultado da calibração: O resultado é a média das medições.

Gravação

Diâmetro nominal (mm)	Resultado (mm)	Incerteza de medição ( $\mu\text{m}$ )	Fator de abrangência (k)	Graus de liberdade ( $\nu_{\text{eff}}$ )
6,0000	X 1 6,0045	0,5 + L /1500	2,00	Infinito
	X 2 6,0045			
	X 3 6,0044			
	Y 1 6,0039	0,5 + L /1500	2,01	405
	Y 2 6,0040			
	Y 3 6,0038			

### 5- Incerteza de Medição:

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com  $\nu_{\text{eff}}$  graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

### 6 - Nota: Temperatura ambiente ( 20,0 $\pm$ 0,5 ) °C.

Data da calibração: 1 de Novembro de 2023

Data da emissão: 1 de Novembro de 2023

Eduardo Ferreira Miranda  
Signatário autorizado