

**Cliente:** " CONTEMP INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA "

**Endereço:** Alameda Araguaia, 204 - São Caetano do Sul - SP

**Ordem de serviço:** 12096

#### 1 - Objeto calibrado:


**Calibrador Anel Liso Cilindrico**

Fabricante: Ferriplax

Número de série: 44112/1

Código: Não consta

Identificação do proprietário: LAPA-037

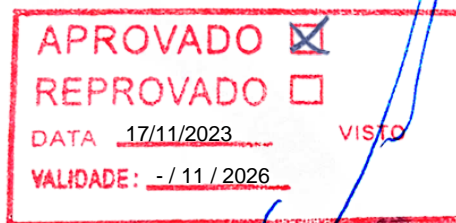

#### 2 - Padrões utilizados na calibração:

Calibrador anel liso cilíndrico

Certificado N° DIMCI 0167/2021 - INMETRO

N° série: 0632

Validade: 03/2024

Maquina de medição por coordenadas

Certificado N° 02549/23 - RBC - Mitutoyo


N° série: 0004501

Validade: 07/2024

#### 3 - Procedimento de medição: PML-0010 - Revisão: 8

O diâmetro do anel foi calibrado nos eixos X e Y, na altura média, conforme figura abaixo.

#### 4 - Resultado da calibração: O resultado é a média das medições.



Diâmetro nominal (mm)	Resultado (mm)	Incerteza de medição (µm)	Fator de abrangencia (k)	Graus de liberdade (Veff)
80,0000	X 80,0014	0,5 + L/1500	2,00	Infinito
	Y 80,0014	0,5 + L/1500	2,00	Infinito

#### 5 - Incerteza de Medição:

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

#### 6 - Nota: Temperatura ambiente ( 20,0 ± 0,5 ) °C.

Data da calibração: 1 de Novembro de 2023

Data da emissão: 1 de Novembro de 2023

Eduardo Ferreira Miranda  
Signatário autorizado